




Patellavator® - Kniebandage

Gebrauchsanleitung Artikel 8373



Öffnen Sie die Bandage und legen Sie diese mit der beschrifteten Seite vorne unterhalb der Patella an.

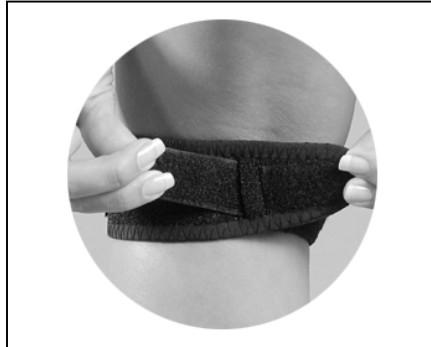

Führen Sie die beiden Enden der Bandage (Klettbänder) nach hinten und ziehen Sie das rechte Klettband durch die Öffnung des linken Klettbandes. Verschließen Sie den Klettverschluss. Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte das Klettband nicht auf der Haut aufliegen. Andernfalls wählen Sie bitte eine andere Größe.



Ziehen Sie die beiden Enden des Klettbandes an den Senkeln straff nach hinten, so dass die Bandage fest und bequem sitzt. Verschließen Sie den Klettverschluss.

Waschanleitung:



Patellavator® - Kniebandage

Gebrauchsanleitung Artikel 8373



Öffnen Sie die Bandage und legen Sie diese mit der beschrifteten Seite vorne unterhalb der Patella an.



Führen Sie die beiden Enden der Bandage (Klettbänder) nach hinten und ziehen Sie das rechte Klettband durch die Öffnung des linken Klettbandes. Verschließen Sie den Klettverschluss. Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte das Klettband nicht auf der Haut aufliegen. Andernfalls wählen Sie bitte eine andere Größe.



Ziehen Sie die beiden Enden des Klettbandes an den Senkeln straff nach hinten, so dass die Bandage fest und bequem sitzt. Verschließen Sie den Klettverschluss.

Waschanleitung:




Patellavator® Kniebandage

Gebruiksaanwijzing artikel 8373



Maak de bandage aan de achterzijde los en plaats de bandage met het MedSpec logo recht op aan de voorzijde net onder de patella.

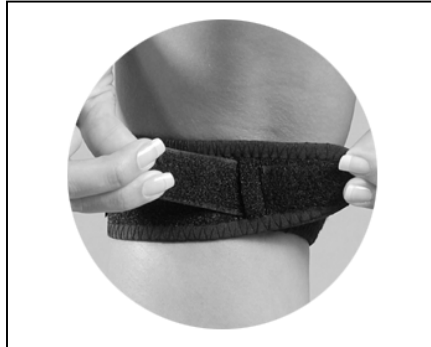

Steek de velcroband aan de rechterzijde zo ver door de opening in de linkerzijde van de bandage, dat er geen velcro haak meer in contact kan komen met de huid.
Als de bandage hierdoor oncomfortabel strak komt te zitten moet een grotere maat genomen worden.




Trek de veters aan de buitenzijde van de bandage naar de achterzijde en bevestig deze aan de achterzijde op het klittenband.

Wasinstructie:




Patellavator® Kniebandage

Gebruiksaanwijzing artikel 8373

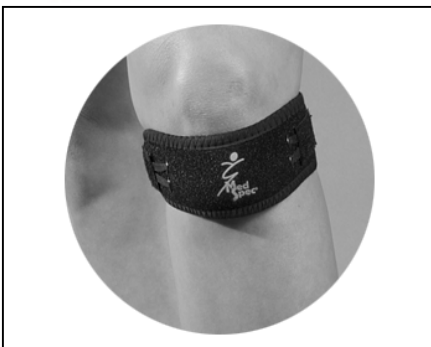

Maak de bandage aan de achterzijde los en plaats de bandage met het MedSpec logo recht op aan de voorzijde net onder de patella.

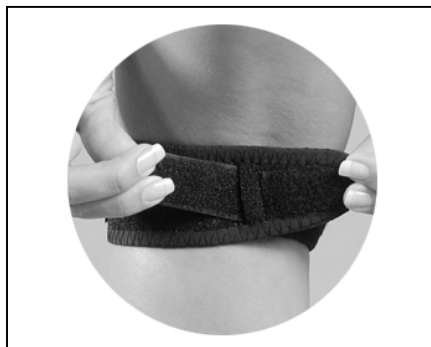

Steek de velcroband aan de rechterzijde zo ver door de opening in de linkerzijde van de bandage, dat er geen velcro haak meer in contact kan komen met de huid.
Als de bandage hierdoor oncomfortabel strak komt te zitten moet een grotere maat genomen worden.



Trek de veters aan de buitenzijde van de bandage naar de achterzijde en bevestig deze aan de achterzijde op het klittenband.

Wasinstructie:

