

Formulaire de travail pour une orthèse sur mesure COS-EVO-Triple Action **A376** pour adultes

Information de contact

Entreprise: _____

Téléphone: _____

Personne de contact: _____

Télécopieur: _____

Rue: _____

Courriel: _____

Code postale: _____ Ville: _____

Numéro de client: _____

Information du patient/de la patiente

Numéro de client: _____

Sexe: Homme Femme

Diagnostique: _____

Côté concerné: Gauche Droit

Poids: _____ kg Taille: _____ cm

Âge: _____

Niveau d'activité: Bas Modéré Élevé

Semelles orthopédiques: Oui Non

Conditions pour la mesure

1. Le négatif plâtré doit être fait de gypse plastique.
2. Plâtrez les deux jambes en les chargeant de manière égale en position neutre avec le pied à 90° où la ligne de charge passe perpendiculairement par la hanche, le genou et la cheville.
3. Le négatif plâtré est composé d'une épaisseur appropriée partout (2 à 3 couches) avec le numéro d'identification du patient écrit dessus.
4. Si le patient utilise des semelles orthopédiques, celles-ci doivent être portées pendant la mesure.
5. Marquez une ligne perpendiculaire à l'avant (ventrale) et à l'extérieur (latérale) sur le modèle en plâtre.
6. L'apex des malléoles médiales et latérales doit être clairement marqué.
7. En cas de rotations divergentes, indiquez clairement la ligne de déviation souhaitée.
8. Le négatif plâtré doit être fermé après le moulage en plâtre afin de conserver la forme souhaitée.
9. Faites un dessin du contour de la semelle intérieure de la chaussure.

REMARQUE: Vérifiez que tous les champs demandés ont été remplis sur le formulaire et envoyez-le avec le plâtre. En cas d'ambiguïté ou pour obtenir de l'aide pour prendre la taille, contactez Basko Healthcare.

Tous négatifs plâtres ne répondant pas aux critères généraux ne seront des lors pas pris en considération

Garantie (de finition)

À partir de la date de livraison, Basko Healthcare offre une garantie d'un an sur une orthèse COS-AFO faite sur mesure et une garantie de finition de 3 semaines. Cette garantie de finition ne s'applique que si les mesures sont effectuées sur une jambe dimensionnellement stable. Chaque 6 mois, un entretien obligatoire doit être effectué. L'orthèse est fabriquée à partir de Prepreg. Le Prepreg est un matériau très rigide mais léger (carbone) qui n'est pas déformable en thermoplastique. Il n'est donc pas possible de modifier les thermoplastiques par la suite.

Corrections du négatif plâtré


Pas de corrections nécessaires Exécuter les corrections au-dessous

Cheville Flexion dorsale +_____° **Pied** Endorotation +_____° Varus +_____°

Flexion plantaire +_____° Exorotation +_____° Valgus +_____°

Remarques:

Modèle

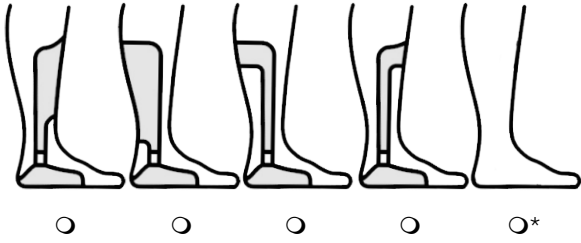

* Forme marquée sur le modèle en plâtre

Exécution

Bilatérale (B)*
(2 articulations TA)

Sans Booster

- COS-B-3A76-A0+A1-L
- COS-B-3A76-A1+A0-R

Booster dorsal

- COS-B-3A76-A2+A3-L
- COS-B-3A76-A3+A2-R

Bilatérale (B)**

(1 articulation TA + arti. libre Camber Axis)

Sans Booster

- COS-B-3A76-A0+751-L
- COS-B-3A76-A1+751-R

Booster dorsal

- COS-B-3A76-A2+751-L
- COS-B-3A76-A3+751-R

Unilatérale (U)

(1 articulation TA)

Sans Booster

- COS-U-3A76-A0-L
- COS-U-3A76-A1-R

Booster dorsal

- COS-U-3A76-A2-L
- COS-U-3A76-A3-R

Doublure de l'échelle de l'orthèse

- Mousse 3 mm, amovible, noir
- Mousse 6 mm, amovible, noir
- EVA 4 mm, fixe, Aqua noir/gris
- EVA 6 mm, fixe, Aqua noir/gris

Plaque du pied

Hauteur du talon

- 0 mm
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm

Exécution

- Plat
- 1/2 Haute
- Haute


Longueur

- 3/4 Longue
- Longue pleine

Rigidité

- Carbone complet (rigide)
- Mélange carbone/kevlar (avant-pied flexible)

Hauteur proximale de l'échelle de l'orthèse



Mesurez depuis l'apex latéral de la cheville (position de l'articulation de la cheville) jusqu'à l'endroit où vous voulez le bord supérieur de l'échelle de l'orthèse proximale.

Mesures de la jambe inférieure

Hauteur Circonférence Largeur M-L


Prière d'indiquer les mesures en **millimètres**

Côté:

- Gauche
- Droit

MÉDIAL

LATÉRAL

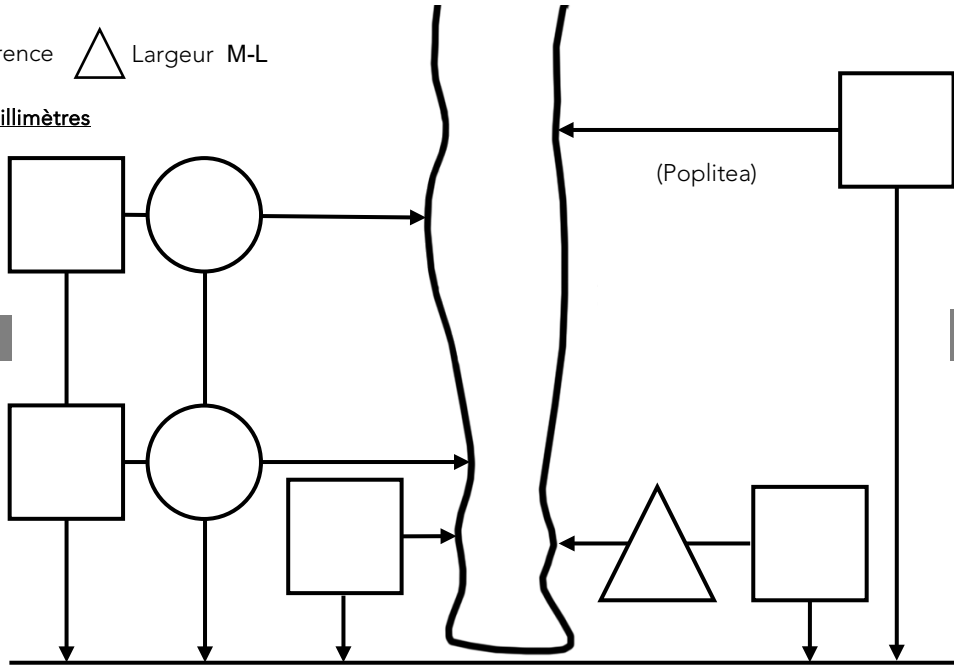

Date

Nom (en caractères d'imprimerie svp)

Signature

Basko Healthcare

Pieter Liefstinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél : +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail : vente@basko.com

basko.com

A large grid for drawing the sole contour. The grid is composed of small squares, approximately 20 squares wide and 40 squares high, providing a space for the user to draw the outline of the sole based on a plaster measurement.

N.B.: Avec la mesure du plâtre, on essaie de faire correspondre au mieux la plaque du pied à la circonférence de la semelle intérieure de la chaussure.
De petits ajustements peuvent être nécessaires par la suite pour optimiser la finition.